

Information om förändrat sätt att förskriva Diabeteshjälpmedel i Beställningsportalen.


Från onsdag den 27 januari förändras förskrivningssättet för er som förskriver, insulinpumpar, CGM och FGM, i Beställningsportalen.

Alla nya förskrivningar kommer från och med 27 januari att göras under Hjälpmedelsområde *Diabetes* och Leverantör *Medicinteknisk apparatur i hemmet, MAH*.

De förskrivningar som är gjorda före 2021-01-27 kommer att föras över till denna vy i Beställningsportalen med uppdatering om hur många uttag som finns kvar, när förskrivning gjordes, när senaste uttaget gjordes. Kvarstående uttag kan nu även aktiveras i Beställningsportalen av förskrivare eller av brukaren via 1177 samt i direktkontakt med MAH.

Följande flöde gäller:

1. Logga in i Beställningsportalen

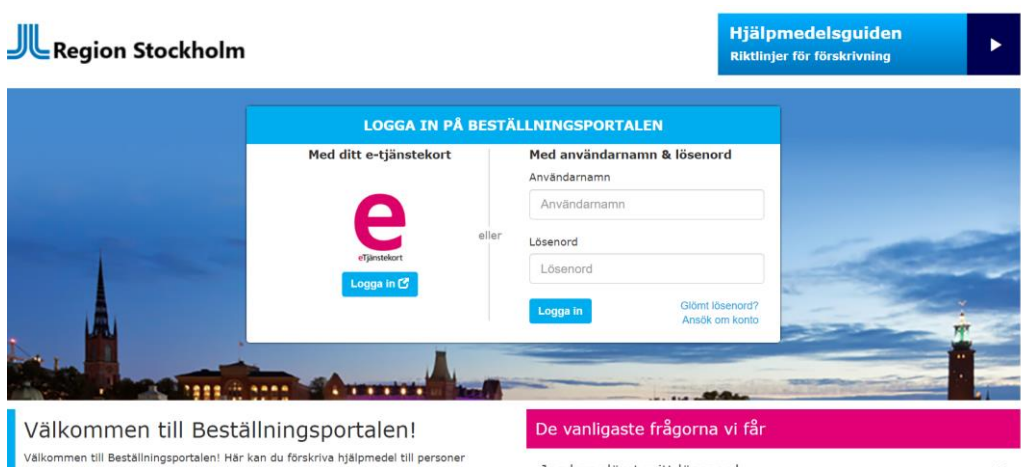

2. Ändra mina val så att hjälpmedelområdet *Diabetes* kan väljas



3. Välj Diabetes och MAH

Välj hjälpmedelsområde

ADL, förflyttning, decubitus, larm, omgivningskontroll, stimulatorer
 Kommunikation-, kognition-, synhjälpmedel
 Medicinteknisk apparatur i hemmet (MAH)
 Diabetes
 Förband och annat sjukvårdsmaterial
 Inkontinens
 Näring

Välj hjälpmedelsleverantör

Förbrukningshjälpmedel i hemmet
 Medicinteknisk apparatur i hemmet (MAH) - Diabetes

[Spara mina val](#)

4. Efter angivet personnummer visas **Brukarhistorik med möjlighet att:**


- utföra ny förskrivning
- aktivera ett nytt uttag
- makulera förskrivning direkt i Beställningsportalen istället för att ringa MAH
- förnya artikel, när tidigare uttag är slut

Brukarhistorik ? Hjälp

Här kan du söka en brukare och se dess tidigare förskrivningar. Här kan du välja en artikel för att beställa uttag, förnya eller makulera den.

<p>Vald brukare</p> <p>Tolvan Tolv Tolvan 19121212-1212, TOLVAR STIGENGATAN 15 LGH 1304 12345 STOCKHOLM</p> <p>Ändra kontaktuppgifter till brukaren</p> <p>Vad vill du göra</p> <p>Ny förskrivning</p> <p>Sök ny brukare</p> <p><input type="text"/></p> <p><input type="button" value="Sök brukare"/></p>	<p>Brukarens senaste förskrivna artiklar Visa alla tidigare artiklar</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; padding: 5px;"> <p>Startpaket Sensorbaserad glukosmätning Freestyle Libre</p> <p>Abbott Scandinavia AB Mer info om artikeln</p> <p>Förskriven 2020-08-28 Mer info om förskrivningen</p> <p>Senast uttag 2020-09-28</p> <p>Betalsätt MAH_D Test</p> <p>Status</p> </td> <td style="width: 40%; padding: 5px;"> <p>2 uttag kvar</p> <p>4 uttag förskrivet</p> <p>0 st per dygn</p> <p>1 st per uttag</p> <p>1 förp per uttag</p> <p style="text-align: right;"> > Beställ uttag X Makulera </p> </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> <p>Sensor FreeStyle Libre för glukosmätning</p> <p>Abbott Scandinavia AB Mer info om artikeln</p> <p>Förskriven 2020-09-14 Mer info om förskrivningen</p> <p>Senast uttag 2020-09-23</p> <p>Betalsätt</p> <p>Förskrivare MAH_D Test</p> <p>Status</p> </td> <td style="padding: 5px;"> <p>1 uttag kvar</p> <p>4 uttag förskrivet</p> <p>0 st per dygn</p> <p>1 st per uttag</p> <p>1 förp per uttag</p> <p style="text-align: right;"> > Beställ uttag X Makulera </p> </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> <p>Sensorbaserad avläsare för glukosmätning FreeStyle Libre</p> <p>Abbott Scandinavia AB Mer info om artikeln</p> <p>Förskriven 2020-09-14 Mer info om förskrivningen</p> <p>Senast uttag 2020-09-14</p> <p>Betalsätt</p> <p>Förskrivare MAH_D Test</p> <p>Status Makulerad 2020-10-28</p> </td> <td style="padding: 5px;"> <p>3 uttag kvar</p> <p>4 uttag förskrivet</p> <p>0 st per dygn</p> <p>1 st per uttag</p> <p>1 förp per uttag</p> <p style="text-align: right;"> > Förnya artikel </p> </td> </tr> </table>	<p>Startpaket Sensorbaserad glukosmätning Freestyle Libre</p> <p>Abbott Scandinavia AB Mer info om artikeln</p> <p>Förskriven 2020-08-28 Mer info om förskrivningen</p> <p>Senast uttag 2020-09-28</p> <p>Betalsätt MAH_D Test</p> <p>Status</p>	<p>2 uttag kvar</p> <p>4 uttag förskrivet</p> <p>0 st per dygn</p> <p>1 st per uttag</p> <p>1 förp per uttag</p> <p style="text-align: right;"> > Beställ uttag X Makulera </p>	<p>Sensor FreeStyle Libre för glukosmätning</p> <p>Abbott Scandinavia AB Mer info om artikeln</p> <p>Förskriven 2020-09-14 Mer info om förskrivningen</p> <p>Senast uttag 2020-09-23</p> <p>Betalsätt</p> <p>Förskrivare MAH_D Test</p> <p>Status</p>	<p>1 uttag kvar</p> <p>4 uttag förskrivet</p> <p>0 st per dygn</p> <p>1 st per uttag</p> <p>1 förp per uttag</p> <p style="text-align: right;"> > Beställ uttag X Makulera </p>	<p>Sensorbaserad avläsare för glukosmätning FreeStyle Libre</p> <p>Abbott Scandinavia AB Mer info om artikeln</p> <p>Förskriven 2020-09-14 Mer info om förskrivningen</p> <p>Senast uttag 2020-09-14</p> <p>Betalsätt</p> <p>Förskrivare MAH_D Test</p> <p>Status Makulerad 2020-10-28</p>	<p>3 uttag kvar</p> <p>4 uttag förskrivet</p> <p>0 st per dygn</p> <p>1 st per uttag</p> <p>1 förp per uttag</p> <p style="text-align: right;"> > Förnya artikel </p>
<p>Startpaket Sensorbaserad glukosmätning Freestyle Libre</p> <p>Abbott Scandinavia AB Mer info om artikeln</p> <p>Förskriven 2020-08-28 Mer info om förskrivningen</p> <p>Senast uttag 2020-09-28</p> <p>Betalsätt MAH_D Test</p> <p>Status</p>	<p>2 uttag kvar</p> <p>4 uttag förskrivet</p> <p>0 st per dygn</p> <p>1 st per uttag</p> <p>1 förp per uttag</p> <p style="text-align: right;"> > Beställ uttag X Makulera </p>						
<p>Sensor FreeStyle Libre för glukosmätning</p> <p>Abbott Scandinavia AB Mer info om artikeln</p> <p>Förskriven 2020-09-14 Mer info om förskrivningen</p> <p>Senast uttag 2020-09-23</p> <p>Betalsätt</p> <p>Förskrivare MAH_D Test</p> <p>Status</p>	<p>1 uttag kvar</p> <p>4 uttag förskrivet</p> <p>0 st per dygn</p> <p>1 st per uttag</p> <p>1 förp per uttag</p> <p style="text-align: right;"> > Beställ uttag X Makulera </p>						
<p>Sensorbaserad avläsare för glukosmätning FreeStyle Libre</p> <p>Abbott Scandinavia AB Mer info om artikeln</p> <p>Förskriven 2020-09-14 Mer info om förskrivningen</p> <p>Senast uttag 2020-09-14</p> <p>Betalsätt</p> <p>Förskrivare MAH_D Test</p> <p>Status Makulerad 2020-10-28</p>	<p>3 uttag kvar</p> <p>4 uttag förskrivet</p> <p>0 st per dygn</p> <p>1 st per uttag</p> <p>1 förp per uttag</p> <p style="text-align: right;"> > Förnya artikel </p>						

5. Vid Ny förskrivning ska funktionsområde väljas

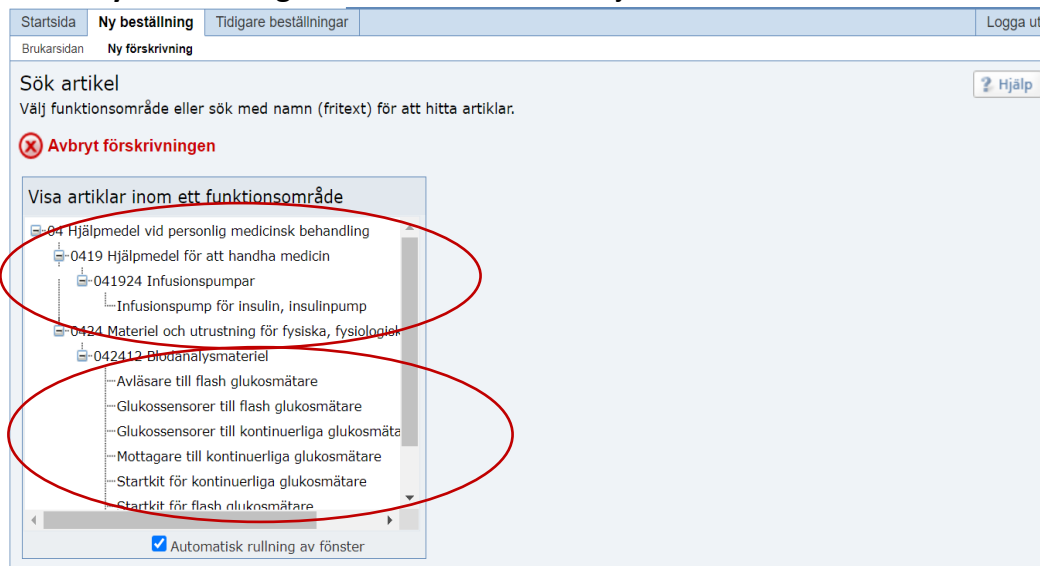

Startsida Ny beställning Tidigare beställningar Logga ut

Bruksarsidan Ny förskrivning

Sök artikel
 Välj funktionsområde eller sök med namn (fritext) för att hitta artiklar. Hjälp

Avbryt förskrivningen

Visa artiklar inom ett funktionsområde

- 04 Hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling
 - 0419 Hjälpmedel för att handha medicin
 - 041924 Infusionspumpar
 - Infusionspump för insulin, insulinpump
 - 0424 Materiel och utrustning för fysiska, fysiologiska
 - 042412 Blodanalysmateriel
 - Avläsare till flash glukosmätare
 - Glukossensorer till flash glukosmätare
 - Glukossensorer till kontinuerliga glukosmätare
 - Mottagare till kontinuerliga glukosmätare
 - Startkit för kontinuerliga glukosmätare
 - Startkit för flash glukosmätare

Automatisk rullning av fönster

6. Förskrivning med möjlighet till upprepade uttag.

- Antal per uttag = antal som beställs vid varje uttag
- Antal uttag = hur många gånger uttag kan göras under 2 år

CGM Sensorer Rubin Medical

042412 - Blodanalysmateriel
 Glukossensorer till kontinuerliga glukosmätare

Här ingår produkter för mätning av tex blodets koagulationsförmåga vid warfarinbehandling samt blodets insulinhalt.

Kommentar från Medicinteknisk apparatur i hemmet (MAH) - Diabetes MAH. Ange i leveranskommentarsrutan hur många gånger på ett år som brukaren ska kunna få denna sändning utan ny förskrivning. Om leverans ska ske till barn, ange målsmans namn i leveranskommentarsrutan. Återrapportering av levererat antal till Best

Sök och lägg till fler artiklar Senast ändrat: 2020-08-07

Sensorer		Pris/st	Kr	Kommentar:	Antal per uttag	Lägg till
CGM sensorer Animas Dexcom G4 PLATINUM Rubin Medical AB Förp strl: 0 styck Art.nr: 2244601 Mer information	673,97	1-handsvän		1 fp = 4 st. Ange antal fp brukaren behöver vid en sändning. (Antal 1 = 4 st, 2 = 8 st osv.)	<input type="text"/>	<input type="text"/>

7. Välj leveranssätt

Vid förskrivning till barn under 18 år med leverans till brukaren är fältet Vårdnadshavare obligatoriskt. Skriv in personens korrekta namn. Detta krävs för att leveransen ska kunna hämtas ut mot uppvisad legitimation. Leveranssätt är inte valbart utan är alltid Utlämningsställe

Välj leveransadress

Observera att de flesta paket inte kan levereras till boxadress

<input checked="" type="radio"/> Brukarens	Efternamn, Förnamn	Barn 2014 Testbrukare	Leveranskommentar (OBS! Ange ej adress här.) Max 250 tecken (250 kvar)
<input type="radio"/> Förskrivarens	Vårdnadshavare	Sture Sturesson	
<input type="radio"/> Senaste uttag	Leveransadress	TESTVÄGEN 9	
<input type="radio"/> Annan	c/o		
	Postadress	12345 TESTHOLM	
	Telefon	072-3678888	Leveranssätt <input checked="" type="radio"/> Utlämningsställe
	Mobiltelefon	9999999999	

Slutför och skicka beställningen.